



(11) RO 125259 B1

(51) Int.Cl.

G01N 21/64 (2006.01),

G01N 21/39 (2006.01),

G01N 21/71 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2008 00357**

(22) Data de depozit: **14.05.2008**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **28.02.2012** BOPI nr. **2/2012**

(41) Data publicării cererii:
26.02.2010 BOPI nr. **2/2010**

(73) Titular:

• INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000,
STR. ATOMIȘTILOR NR. 1, MĂGURELE, IF,
RO

(72) Inventatori:

• STRIBER JOAKIM, STR.MĂRTIŞOR
NR.54 B, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
• ANGHELUTĂ MARIAN LAURENTIU,
STR.ZLAŞTI NR.43, HUNEDOARA, HD, RO;

• RĂDVAN ROXANA,
STR.RÂMNICU SÂRAT NR.15, BL.20F,
SC.1, ET.5, AP.13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, RO;
• SIMILEANU MONICA, STR.ABRUD
NR.140, BL.12C, SC.B, ET.8, AP.78,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO;
• SAVASTRU ROXANA, STR.IANI
BUZOIANI NR.3, BL.16, SC.A, AP.2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
US 5379103

(54) **DISPOZITIV OPTOELECTRONIC ȘI PROCEDEU PENTRU
ANALIZA CALITATIVĂ A SUPRAFEȚELOR OBIECTELOR DE
ARTĂ CU TEHNICA LIF**

Examinator: ing. DUMITRU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat,
la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în
termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de
acordare a acesteia

RO 125259 B1

1 Inventia se referă la un procedeu și la un dispozitiv pentru analiza calitativă a supra-
3 fețelor obiectelor de artă, constând în analiza spectrală a emisiei de fluorescentă, rezultată
din relaxarea moleculelor excitate cu ajutorul unei radiații laser generată de un laser YAG:Nd
la lungimea de undă de 266 nm.

5 Sunt cunoscute procedee de caracterizare calitativă prin analize chimice distructive,
pentru care se preleveză probe care sunt procesate în laborator, și procedee de depistare
7 a contaminării microbiologice prin prelevare de probe și urmărirea în laboratoare
specializate, ambele categorii de procedee necesitând timp.

9 O tehnică de investigare care folosește laserul pentru inducția fenomenelor de
11 fluorescentă este spectroscopia fluorescentei induse cu ajutorul laserului (LIF sau LIFS -
13 Laser Induced Fluorescence [Spectroscopy]). Spectrele astfel obținute fiind specifice fiecărui
material, conduc la caracterizarea compoziției suprafeteelor. Spectroscopia fluorescentei
indusă cu ajutorul laserului este o tehnică non-destructivă. Emisiile de la suprafața obiectului
iradiat cu laser sunt achiziționate și interpretate cu echipament și software specializat.

15 Un document care se referă la folosirea tehniciilor LIBS și LIF pentru analiza
poluanților din apa din sol este brevetul US 5379103 A (Ziegler Arie, 1995). Aparatul
17 cuprinde un laser de tip Nd:YAG cu posibilități de dublare sau triplare a frecvenței de emisie,
cu o valoare a energiei eliberate de 0,3 J în 10 ns, cu o frecvență a impulsurilor de 10 s.
19 Semnalul cules din proba excitată cu fasciculul laser trece printr-o fibră optică și este
prelucrat cu niște lentile, pentru a fi analizat de un spectrometru. Aparatul mai conține un
21 detector al energiei fluorescente.

23 Metoda de lucru constă în emiterea impulsurilor laser cu focalizarea energiei pe
proba de analizat, generând electroni pe stări excitate și măsurând caracteristicile spectrale
25 ale energiei emise de către probă, pentru identificarea substanțelor din aceasta (metale,
substanțe organice).

27 Tehnicile LIF sau LIBS se folosesc selectiv prin modificarea focalizării spotului laser.
Pentru tehnica LIF are loc reglarea unei lentile astfel încât să se obțină difuzarea spotului și
29 apariția fluorescentei particulelor excitate. Pentru tehnica LIBS, o altă lentilă focalizează
spotul laser asupra probei, cu formarea de plasmă cu temperatură înaltă, din care se
decelează caracteristicile liniilor spectrale apropiate ale substanțelor din plasmă.

31 Metodele se identifică prin liniile spectrale, folosind tehnica LIBS, iar substanțele
organice sunt identificate prin caracteristicile energiei de fluorescentă, determinate cu
33 tehnica LIF.

35 Problema tehnică pe care o rezolvă inventia este îmbunătățirea dispozitivelor și
procedeeelor pentru analiza suprafeteelor obiectelor de artă. Soluția tehnică constă în
37 realizarea unui dispozitiv de scanare care se bazează pe un procedeu de caracterizare și
diagnosticare a suprafeteelor, ce utilizează efectul fluorescentei induse prin iradiere laser
controlată. Procedeul constă în analiza punct cu punct a întregii suprafete. Procedeul este
39 non-contact, non-invaziv, cu înaltă rezoluție. O analiză complexă asupra unei suprafete se
poate face analizând nu doar puncte alese arbitrar, ci o întreagă suprafață. Acest lucru este
41 posibil utilizând un sistem coaxial automatizat, care permite sincronizarea proceselor de
poziționare și detectie.

43 Se prezintă în continuare elementele componente ale dispozitivului pentru analiza
suprafeteelor obiectelor de artă, conform cu fig. 1 și 2, care reprezintă:

- 45 - fig. 1, ansamblul dispozitivului optoelectric;
47 - fig. 2, diagramă temporală.

49 - Sursa de iradiere [L] este un laser cu mediu activ solid, care operează în modul
Q-Switched pasiv, pompat de o diodă care emite la 266 nm, cu frecvență maximă de 3 KHz,
cu o energie de 1,25 μJ per puls, având un diametru al fascicolului de 200 ±100 μm;

RO 125259 B1

- Detectorul [SP] este un spectrometru sensibil în domeniul vizibil, cu o eficiență cuantică de până la 90%, care detectează radiație pe o bandă între 200 și 1100 nm; acesta are posibilitatea de a fi triggerat extern, cu ajutorul unui sistem electronic (break-out box) [TRIG] care primește o comandă generată în LabVEEW, retransmisă la spectrometru odată cu comanda pentru schimbarea de poziție a motoarelor. Spectrometrul primește informație de la colectorul optic L2 printr-o fibră optică FO .	1
- Lentila de colimare [L1] este poziționată la ieșirea radiației din capul laser, pentru focalizarea fasciculului în vederea măririi rezoluției de scanare;	7
- Oglinda perforată [O1] este folosită pentru propagarea fasciculului laser către oglinda [O2];	9
- Oglinda de poziționare [O2] este montată pe ansamblul M ;	11
- Oglinda de redirecționare [O3] transmite radiația de fluorescentă în cadrul dispozitivului către colectorul optic L2 ;	13
- Filtrul optic [F] este un filtru optic care elimină maximele de difracție de ordin doi și trei și blochează energia de excitație;	15
- Colectorul optic [L2] este un sistem convergent cu posibilitate de focalizare în aer liber;	17
- Ansamblul de rotire al oglinzii [M] este alcătuit din două servo-motoare care asigură rotirea cu aceeași precizie pe două axe perpendiculare. Precizia de rotație în ambele planuri este de 0,0005° și o viteză maximă de 80°/s.	19
- Controlerul [CTRL] reprezintă componenta electronică de comunicare a motoarelor de rotație cu PC-ul, care se face prin portul serial, fiind controlate de o aplicație software (realizată sub platforma LabView).	21
Modul de funcționare este prezentat în continuare. Sursa de iradiere L emite un fascicul laser care trece prin lentila de colimare L1 și este focalizat la nivelul suprafeței obiectului analizat, trecând prin orificiul oglinzii perforate O1 și redirecționat de oglinda O2 , parte a ansamblului de baleiere M .	25
O parte a emisiei de fluorescentă generată în urma iradierei laser punct cu punct a suprafeței este reflectată de oglinziile O2 , O1 , O3 , traversează filtrul optic F , colectorul optic L2 și este proiectată pe suprafața de intrare în fibra optică FO , cuplată la spectrometrul SP .	29
Dispozitivul este funcțional atât în analize de laborator, cât și pe teren. Cu alte cuvinte, este un ansamblu solid și în același timp portabil, care nu necesită microclimat controlat și nu produce reziduuri chimice.	31
Comunicarea PC-ului cu dispozitivele hardware (spectrometru, motoare etc.) se realizează prin porturile USB, Serial și Paralel, prin intermediul unor aplicații special dedicate.	35
Software-ul de achiziție al spectrometrului permite triggerarea externă a acestuia (spectrometrului). Tot prin acest software, operatorul poate alege doar anumite benzi de lungimi de undă de interes pentru achiziție, lucru care scurtează timpul de lucru și sporește eficiența interpretărilor.	37
Software-ul care coordonează procesul de reposiționare și detectare, este realizat în LabVIEW. Acesta oferă posibilitatea setării tuturor parametrilor de scanare (stabilire punct de start, suprafață de scanare, dimensiune pași orizontali și verticali, distanță față de obiect, timp de așteptare pentru fiecare pas). Motoarele sunt comandate prin portul serial al PC-ului, prin intermediul controlerului CTRL . Același software asigură generarea impulsului de triggerare, transmis prin portul paralel către box-ul de triggerare.	41
	43
	45

Triggerarea spectrometrului este necesară sincronizării între timpul de achiziție și schimbarea de poziție pentru fiecare pas. La fiecare schimbare de poziție a motoarelor - și implicit a spotului laser pe suprafața obiectului de artă - este transmis concomitent un semnal, prin portul paralel, către dispozitivul de triggerare al spectrometrului, eveniment interpretat de software-ul de achiziție ca și moment în care poate începe înregistrarea de date venite de la spectrometru, pe durata de timp setată pentru acumulare.

Timpul de acumulare T_{ac} este timpul în care se realizează iradierea și achiziționarea semnalului pentru un punct de pe suprafața investigată.

Timpul necesar investigării întregii suprafețe de interes va fi un multiplu al timpului unui ciclu. Timpul unui ciclu T_c este alcătuit din: timp de triggerare T_t , timp de acumulare T_{ac} , timp de reposiționare T_p .

Pentru a sincroniza reposiționarea fasciculului laser cu detectarea radiației fluorescente indusă, în cadrul software-ului de scanare timpul pentru triggerare T_t , însumat cu timpul de achiziționare T_{ac} și timpul de reposiționare al motoarelor T_p trebuie să fie mai mare, cel mult egal cu timpul unui ciclu T_c , conform cu fig. 2.

Datele obținute în urma scanării sunt organizate în fișiere separate, fiecare din ele reprezentând, pe câte o coloană, intensitățile medii ale unei benzi spectrale (sau background), pentru fiecare pas parcurs. Acestea sunt interpretate ulterior cu o altă aplicație.

RO 125259 B1

Revendicări

1	Revendicări	1
3	1. Dispozitiv optoelectric pentru analiza calitativă a suprafețelor obiectelor de artă prin scanare cu tehnica LIF, caracterizat prin aceea că este alcătuit dintr-un laser cu mediu activ solid YAG:Nd care funcționează pulsat la o frecvență de 3 KHz cu energie de 1,25 µJ per puls și emite la lungimea de undă 266 nm, două servo-motoare (M) cu o precizie de rotație de 0,0005°, care ating o viteză maximă de 80°/s, un filtru optic (F) care elimină maximele de difracție de ordin doi și trei, și blochează energia de excitație, un colector optic (L2), o fibră optică (FO), un spectrometru cu bandă spectrală între 200 și 1100 nm, cu eficiență de peste 90%, și timp de acumulare între 8 ms și 10 min și dispozitive optice de tip lentile (L1, L2) și oglinzi (O1, O2, O3).	11
5	2. Procedeu de analiză calitativă a suprafețelor obiectelor de artă prin scanare cu tehnica LIF, folosind dispozitivul conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că , într-o primă etapă se realizează o prestabilire a ariei de scanat, a pasului de scanare atât pe direcție orizontală, cât și verticală, într-o o a doua etapă are loc iradierea controlată punct cu punct a ariei de investigat pe suprafața obiectului și colectarea concomitentă a fluorescenței emise, iar în a treia etapă are loc interpretarea semnalului de fluorescentă emis de suprafața iradiată.	17
7		
9		
13		
15		

(51) Int.Cl.

G01N 21/64 (2006.01);

G01N 21/39 (2006.01);

G01N 21/71 (2006.01)

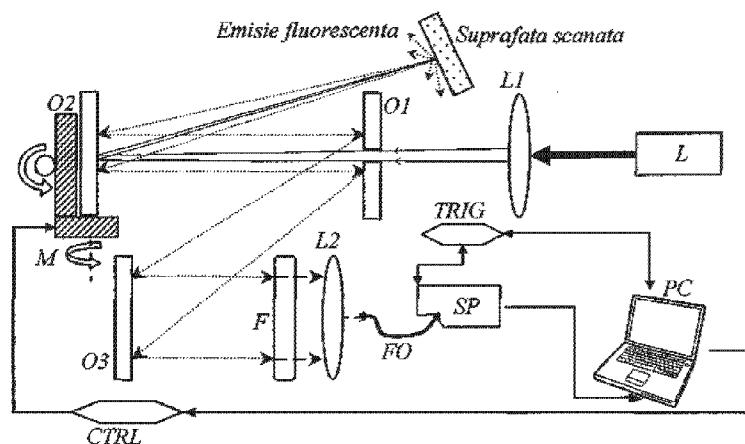


Fig. 1

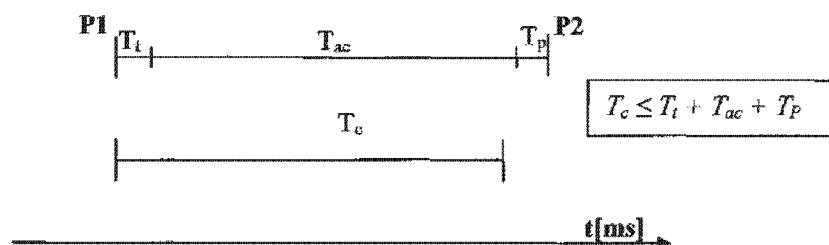


Fig. 2



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci
sub comanda nr. 85/2012