



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00848**

(22) Data de depozit: **23.10.2009**

(41) Data publicării cererii:
29.07.2011 BOPI nr. **7/2011**

(71) Solicitant:
• UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE"
DIN SUCEAVA, STR.UNIVERSITĂȚII NR.13,
SUCEAVA, SV, RO

(72) Inventatori:

• GUTT ANDREI, STR.VICTORIEI NR.185
BIS, SAT SFÂNTU ILIE, SV, RO;
• GUTT SONIA, STR.VICTORIEI NR.185
BIS, SAT SFÂNTU ILIE, SV, RO;
• GUTT GHEORGHE, STR.VICTORIEI
NR. 185 BIS, SAT SFÂNTU ILIE, SV, RO


(54) BIOSENZOR DE GLUCOZĂ

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un biosenzor de glucoză, folosit pentru determinarea conținutului de glucoză din sânge. Biosenzorul conform inventiei este format dintr-un corp (1) în interiorul căruia se găsește o unitate (2) electro-merică amperometrică pentru măsurarea currentului de electroliză, precum și pentru prelucrarea și afișarea datelor pe un display (3) electronic, în exterior corpul (1) fiind prevăzut cu un sistem de dozare format dintr-o piuliță (4) randalinată, un clichet divizor prevăzut cu bilă (5) și arc (6), un șurub (7) de presare, un știft (8) cilindric pentru împiedicarea deplasării pe verticală a piuliței (4), un cuțit (9) de perforare, un tub (10) capilar din plastic, o celulă (11) de amestecare și reacție prevăzută cu un canal (c) deschis și doi electrozi (12 și 13) lamelari, realizati din platini, tot în partea exterioară a corpului (1) mai este montat prin înfiletare un flacon (15) de plastic care conține glucozoxidază (g) lichidă și care este prevăzut cu un piston din plastic.


Revendicări: 1

Figuri: 1

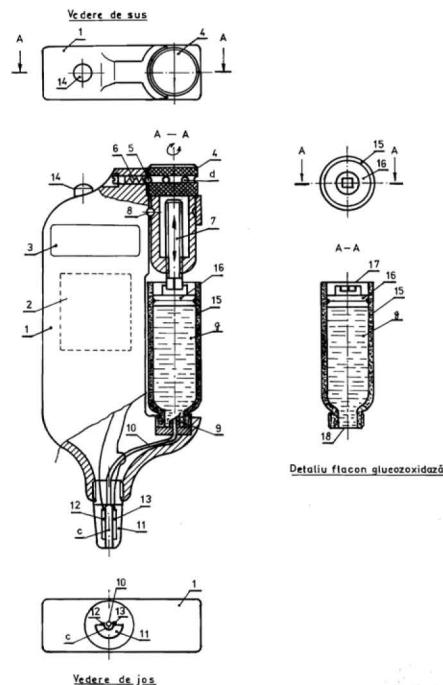

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de invenție este determinată de revendicările conjuinate în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).




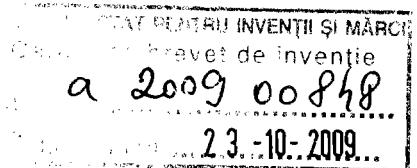

BIOSENZOR DE GLUCOZĂ

Invenția se referă la un biosenzor pentru determinarea in situ a concentrației glucozei din sânge.

La ora actuală, pentru determinarea in situ a glucozei din sânge la diabetici și la sportivi este produs și folosit un biosenzor electronic portabil, pentru analiză fiind necesară o singură picătură de sânge ce se aduce pe un suport de plastic de unică utilizare pe care se găsesc doi electrozi între care există o depunere uscată a unui gel ce conține o cantitate de glucozoxidază dozată în aşa fel încât să poată cataliza oxidarea rapidă, în cîteva secunde, a glucozei din picătura de sânge rezultînd gluconolactonă și apă oxigenată după reacția:



Aplicarea unei tensiuni continue constante celor doi electrozi face ca prin produșii de reacție, respectiv prin apa oxigenată, să se închidă un circuit electric de electroliză. Conform legii lui Faraday, intensitatea curentului de electroliză este proporțională cu cantitatea apei oxigenate generate în reacție, cantitate care la rîndul ei este o măsură a masei, și prin aceasta a concentrației, glucozei dintr-o picătura de sânge transformată integral în gluconolactonă. În microprocesorul aparatului intensitatea curentului este transformată, pe baza unei curbe de calibrare memorată electronic, în unități de concentrație de glucoză, valori care sunt afișate pe display-ul digital în unități de mg/dl.

Problema tehnică pe care o rezolvă inventia constă în realizarea unui biosenzor destinat determinării rapide și in situ a concentrației glucozei din sânge cu folosirea catalizatorului glucozoxidază sub formă lichidă, fără folosirea de chituri biologice de unică utilizare.

În acest scop este folosit un biosenzor conform inventiei, format dintr-o structură portabilă ce conține o parte electronică și un flacon etanș cu glucozoxidază din care se dozează manual, cu ajutorul unui sistem de transformare a mișcării de tip șurub-piulită cu clichet și a unui sistem de presare cu piston, un anumit volum de cîțiva cîțiva µl de glucozoxidază printr-un microtub capilar într-un canal îngust al aparatului în care sunt plasați doi electrozi de platină, după care, în același canal, se introduce o picătură de sânge supus analizei. Partea electronică masoară timp de 5 secunde, la interval de 100 ms, curentul de electroliză a apei oxigenate rezultate din reacția de oxidare a glucozei, prelucrează statistic cele cca 50 măsurători, elimină valorile extreme neconcordante, mediază valorile concordante și transformă, cu ajutorul curbei de calibrare memorată electronic, valoarea medie a curentului de electroliză în valori de concentrație de glucoză în sânge, valori care sunt afișate pe display-ul electronic în valori de mg/dl.

Prin aplicarea inventiei se obțin următoarele avantaje:

- se elimină chiturile chimice de unică utilizare reducînd enorm prețul

analizelor de glucoză din sânge

- datorită etanșeității perfecte a flaconului de glucozoxidază crește mult termenul de garanție a acestui produs, din același motiv reproductibilitatea determinărilor este superioară
- prin memorarea electronică a mai multor curbe de calibrare și schimbarea tipului de oxidază este posibilă folosirea aparatului și pentru determinarea altor compuși a căror oxidare este catalizată enzimatic

Se dă în continuare un exemplu de realizare a inventiei în legătură cu figura 1 care reprezintă o vedere în secțiune a biosenzorului enzimatic.

Biosenzorul enzimatic conform inventiei este format dintr-un corp **1** în interiorul căruia se găsește o unitate **2** electronică amperometrică pentru măsurarea curentului de electroliză precum și pentru prelucrarea și afișarea datelor pe un display **3** electronic, iar în exteriorul corpului se găsește un sistem de dozare și măsurare format dintr-o piuliță **4** randalinată cu un divizor **d** incremental a pasului filetului, un clichet cu bilă **5** și arc **6**, un surub **7** de presare, un stift **8** cilindric pentru împiedecarea deplasării pe verticală a piuliței **4** randalinată, un cuțit **9** de perforare, un tub **10** capilar din plastic, o celulă **11** de amestecare și reacție prevăzută la rîndul ei cu un canal **c** și doi electrozi **12** și **13** lamelari din platină celulă în care are loc reacția dintre o picătură **p** de sânge, cîțiva μ l de glucozoxidază **g** și oxigenul **O₂** din aer rezultînd gluconolactonă și apă oxigenată, cantitatea ultimei fiind determinată amperometric. Tot în partea exterioară a corpului **1** se mai găsește un buton **14** de pornire/oprire, un flacon **15** de plastic, montat prin înfiletare pe corpul **1**, ce conține glucozoxidază **g** lichidă, un piston **16** din plastic și două membrane **17** și **18** de etanșare termosudate pe flaconul **15** de plastic în starea de livrare a acestuia, aceste membrane fiind ulterior perforate de către cuțitul **9** respectiv surubul **7** de presare atunci cînd flaconul **15** de plastic se montează pe corpul **1** al biosenzorului în vederea efectuării de analize.

REVENDICARE

Invenția Biosenzor de glucoză caracterizat prin aceea că în vederea determinării in situ a conținutului de glucoză din sânge, prin metoda amperometrică cu glucozoxidază sub formă lichidă, este folosit un biosenzor format dintr-un corp (1) în interiorul căruia se găsește o unitate (2) electronică amperometrică pentru măsurarea curentului de electroliză precum și pentru prelucrare și afișarea datelor pe un display (3) electronic, iar în exteriorul acestuia se găsește un sistem de dozare format dintr-o piuliță (4) randalinată, un clichet divizor prevăzut cu bilă (5) și arc (6), un surub (7) de presare, un stift (8) cilindric pentru împiedecarea deplasării pe verticală a piuliței (4) randalinată, un cuțit (9) de perforare, un tub (10) capilar din plastic, o celulă (11) de amestecare și reacție prevăzută la rîndul ei cu un canal (c) deschis și doi electrozi (12 și 13) lamelari din platină, tot în partea exterioară a corpului (1) se mai găsește un flacon (15) de plastic, montat prin înfiletare, ce conține glucozoxidază (g) lichidă și un piston (16) din plastic.

23-10-2009

11

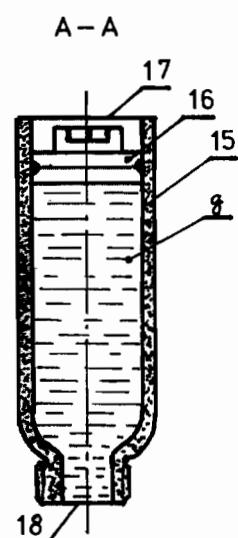
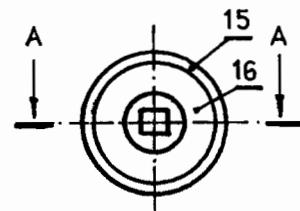
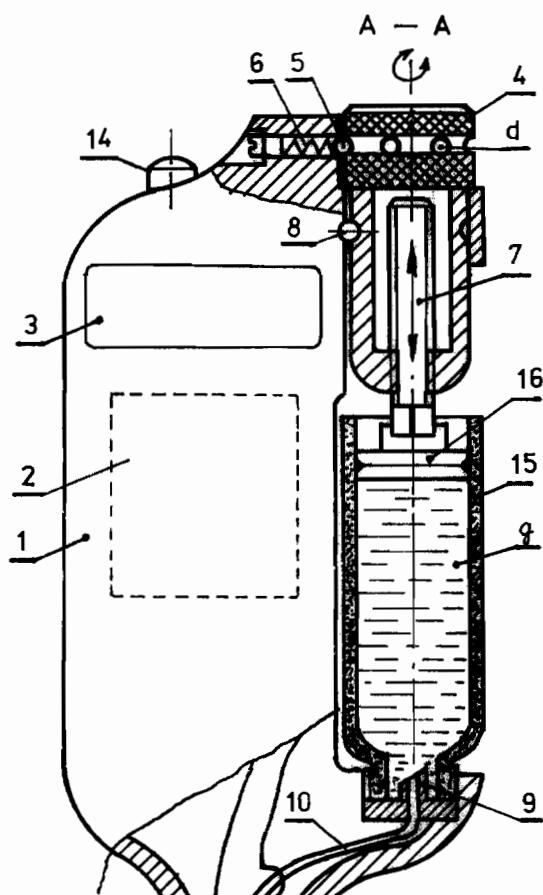
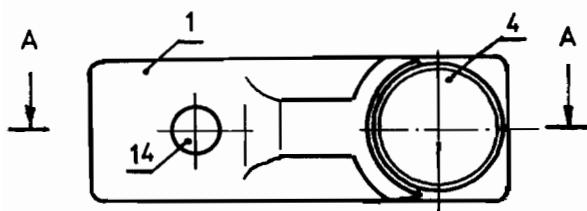
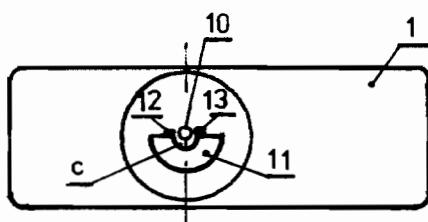

Vedere de susDetaliu flacon glucozoxidazaVedere de jos

FIG. 1