



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2016 00373**

(22) Data de depozit: **25/05/2016**

(41) Data publicării cererii:  
**29/11/2017** BOPI nr. **11/2017**

(71) Solicitant:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE  
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA,  
SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• DOBRIN ION, STR.BABA NOVAC NR.22,  
BL.24 C, SC.B, ET.2, AP.67, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO;

• APOSTOL SIMONA EMILIA,  
ȘOS. GIURGIULUI NR. 126, BL. 7, SC. 2,  
ET. 3, AP. 45, SECTOR 4, BUCUREȘTI, B,  
RO;  
• POPOVICI IULIU ROMEO,  
CALEA GRIVIȚEI NR.403, BL.R, SC.C, ET.3,  
AP.16, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;  
• DOBRIN ANDREI,  
STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 62, BL. G14,  
AP. 16, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO;  
• ENACHE DAN, STR. CĂLĂRAȘI NR. 24,  
FETEȘTI, IL, RO;  
• STOICA VICTOR, ALEEA UIOARA NR. 4,  
BL. 48, SC. 3, AP. 53, SECTOR 4,  
BUCUREȘTI, B, RO

### (54) ANSAMBLU MAGNETIC SUPRACONDUCTOR, PENTRU MĂSURAREA MOMENTELOR MAGNETICE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un ansamblu magnetic supraconductor pentru măsurarea momentelor magnetice atomice sau nucleare, cu aplicații în domeniul fizicii atomice sau nucleare. Ansamblul magnetic supraconductor, conform invenției, este alcătuit dintr-un magnet supraconductor cu două bobine supraconductoare (3), care sunt răcite la 50...20 K de către un criorăcitor (2) prin intermediul unui șunt termic (4) și sunt protejate la radiație termică de 300 K de un ecran termic (5) care, prin cuplare la treapta de 50 K a unui alt criorăcitor (1), reduce transferul termic radiativ la un nivel de 1,5 Watt, în care o probă (10) supusă măsurătorii este cuplată termic la criorăcitor (2), pentru controlul temperaturii acesteia, în domeniul 4,2...300 K, ansamblul fiind introdus într-o incintă vidată, criostat (6) care prezintă două canale axiale (7, 8) ce trec prin magnetul supraconductor și un alt canal (9) pentru introducerea probei (10) într-o poziție fixă în interiorul zonei de câmp uniform, obținut prin alimentarea bobinelor supraconductoare (3) de la o sursă de curent continuu programabilă, zonă care este folosită pentru accesul radiațiilor Y sau particulelor elementare, în scopul aplicării acestora pe probă (10) și înregistrarea radiației emise de către niște detectori (D1, D2, D3).

Revendicări: 1

Figuri: 2

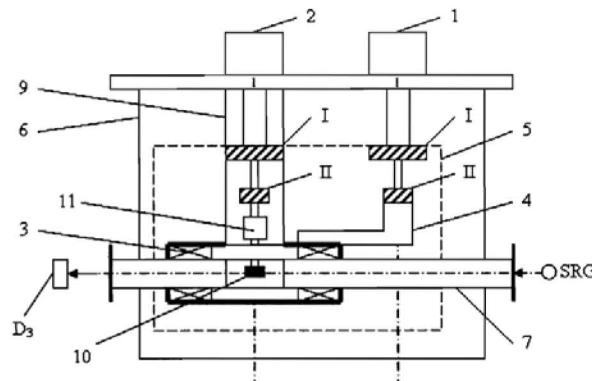


Fig. 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Înținderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



18

OPERAȚIUNI DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MĂRCHI	
Cerere de brevet de invenție	
Nr. a	2016 00 343
Data depozit 25 -05- 2016	

## Ansamblu magnetic supraconductor pentru masurarea momentelor magnetice

Inventia se refera la un ansamblu magnetic supraconductor pentru masurarea momentelor magnetice ale atomilor si ale starilor nucleare excitate, cu aplicatii in domeniul fizicii atomice si nucleare.

Se cunosc magnetometre / dispozitive de masurarea a magnetizarii substantelor materialelor, la nivel macro care masoara magnetizarea substantei respective, cu dezavantajul ca proba trebuie miscata/vibrata in interiorul unei bobine supraconductoare pentru a produce o tensiune electromotoare indusa, metoda fiind limitata, avand o limita de sensibilitate.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in realizarea unui ansamblu / dispozitiv supraconductor care prin constructia speciala, permite obtinerea de campuri magnetice intense  $0 - 5T$  de inalta uniformitate a campului ( $10^{-3}$ ) care permite masurarea unor momente magnetice atomice sau nucleare de valoare foarte mica, de ordinul a  $10^{-26} \dots 10^{-27} A \cdot m^2$ .

Ansamblul magnetic supraconductor pentru masurarea momentelor magnetice nucleare, inlatura dezvantajele mentionate prin aceea ca, este alcătuit dintr-un magnet supraconductor cu doua bobine supraconductoare care sunt racite la  $5 - 20 K$  de catre un cioracitor prin intermediul suntelui termic si sunt protejate la radiatia termica de  $300 K$ , de un ecran termic care prin cuplare la treapta de  $50 K$  a unui alt criocooler reduce transferul termic radiativ la un nivel de  $1,5$  Watt; proba de studiu supusa masuratorii este cuplata termic la un cioracitor, pentru controlul temperaturii acesteia, in domeniul  $4,2-300 K$ ; ansamblul este introdus intr-o incita vidata, criostat care prezinta un doua canale axiale ce trec prin magnetul supraconductor si un alt canal pentru introducerea probei de studiu intr-o pozitie fixa in interiorul zonei de camp uniform; prin alimentarea bobinelor supraconductoare de la sursa programabila de c.c. la un curent  $I = 0-500 A$ , se obtine campul magnetic  $B = 0 - 5T$  cu o uniformitate de  $10^{-3}$  in zona centrala a magnetului supraconductor, prin care trec cele doua canale axiale, zona folosita pentru accesul radiatiilor gamma sau particulelor elementare in scopul aplicarii acestora pe proba de studiu si inregistrarea radiatiei emise de catre detectori.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje:

- Posibilitatea masurarii unor momente magnetice atomice sau nucleare de valoare foarte mica  $10^{-26} \dots 10^{-27} A \cdot m^2$ ;
- Constructie simplificata, eficienta si precizia mari;
- Se elimina necesitatea vibrarii probei si a bobinelor de inductie;
- Se obtin campuri magnetice intense ( $0-5T$ ) si uniforme pe zona activa de camp;
- Nu necesita consum de agent criogenic pentru racirea bobinelor supraconductoare.

Se da in continuare un exemplu de realizare al inventiei in legatura cu fig.1 si fig.2 care reprezinta:

fig.1 – sectiune transversala a ansamblului magnetic supraconductor, conform inventiei

fig.2. – vedere de sus a ansamblului magnetic supraconductor, conform inventiei

Ansamblul magnetic supraconductor pentru masurarea momentelor magnetice, conform inventiei este alcătuit dintr-un magnet supraconductor cu două bobine supraconductoare 3 care sunt racite la 5 – 20 K prin intermediul unui sunt termic 4 de către treapta II a crioracitorului 1 și sunt protejate la radiatia termica de 300 K de un ecran termic 5 care prin cuplare la treapta I de 50 K a crioracitorului 1, reduce transferul termic radiativ la un nivel de 1,5 Watt. Ansamblul conform inventiei este introdus într-o incita vidata, criostat 6 care prezinta două canale axiale, 7 și 8 ce trec prin magnetul supraconductor și un alt canal 9 pentru introducerea probei de studiu 10 într-o pozitie fixă, în interiorul zonei de camp magnetic uniform. Proba de studiu, de masurat 10 este în contact termic cu treapta II de racire a crioracitorului 2, pentru racirea acesteia pana la o temperatura finală de 4,2 K. În scopul controlării temperaturii proprii în domeniul 4,2-300 K între proba 10 și treapta II a crioracitorului 2 se amplasează un incalzitor termic 11 care este cuplat la un controler de temperatură (nefigurat) situat în afara ansamblului magnetic supraconductor. Subansamblul format din crioracitorul 1 și proba 10 se introduce prin intermediul canalului 7 care strabate cele două bobine supraconductoare pana în centrul acestora. Canal 9 este cuplat termic la treapta I de racire a crioracitorului 2 și la ecranul termic 5. Subansamblul bobinelor supraconductoare este străbatut pe o directie paralela cu planul bobinelor de către două canale 7 și 8, reciproc perpendiculare, cu rolul de a permite accesul radiatiilor gamma de excitare a probei 10, respectiv de înregistrare prin intermediul detectorilor D1, D2, D3 a radiatiilor emise prin dezexcitarea probei 10. Aceste două canale 7 și 8 sunt cuplate la ecranul termic 5 al ansamblului, în scopul reducerii fluxului termic radiativ de la aceste canale la bobinele supraconductoare.

Ansamblul magnetic supraconductor, conform inventiei functioneaza astfel: Incinta 6 se videaza la o presiune de  $10^{-5}$ - $10^{-6}$  mbar. Se pun în funcțiune crioracitoarele 1 și 2, se așteaptă un interval de 10-15 ore pentru racirea întregului ansamblu la o temperatură finală de 5-20K și se alimentază bobinele supraconductoare 3 de la o sursă programabilă de c.c. (nefigurată) la un curent  $I = 0-500$  A, și se obține o valoare a campului magnetic  $B = 0 - 5T$  cu o uniformitate de  $10^{-3}$ , în zona centrală a magnetului supraconductor. De asemenea se programează temperatura probei 10 la care se dorește efectuarea masurării, prin intermediul controlerului de temperatură. După fixarea acestor doi parametrii proba 10 este supusă unei iradiieri cu raze gama de la o sursă de radiadii gamma SRG, care generează stări nucleare excitate. Prindezexcitarea nucleelor, acestea generează alte radiatii (X sau  $\gamma$ ) care sunt înregistrate de detectorii D1,D2,D3 amplasati în pozițiile necesare. Din informația energetică asupra radiatiilor detectate se pot determina momentele magnetice ale nucleelor excitate .

Se continuă masurările pentru diverse valori ale campului magnetic și/sau ale temperaturii. Ansamblul conform inventiei se mai utilizează și la alte tipuri de determinări de exemplu masurarea oricarei proprietăți magnetice, electrice sau termice, dependente de campul magnetic și/sau de temperatură, în domeniul 0-5T, respectiv 4,2-300K.

Solutia constructiva de racire directa a bobinelor supraconductoare 3 prin intermediul suportului conductiv 4, de către treapta II a crioracitorului 1 și ecranarea

acestora la 50 K fata de criostatul 6, permite functionarea bobinelor 3 in stare supraconductoare si mentinerea canalelor 7 si 8 la o temperatura de 70-80K ceea ce determina mentinerea temperaturii scazute (5-20K) la nivelul bobinelor supraconductoare 3. Totodata este posibila atat schimbarea probei 10 cat si/sau a fluxului de particule/radiatii electromagnetice, fara oprirea functionarii ansamblului magnet supraconductor, conform inventiei si conduce la o exploatare economica din punct de vedere energetic a acestuia.

## Revendicare

Ansamblul magnetic supraconductor pentru masurarea momentelor magnetice nucleare, caracterizat prin aceea ca, este alcătuit dintr-un magnet supraconductor cu două bobine supraconductoare (3) care sunt racite la 5 – 20 K de către crioracitorul (2) prin intermediul suntelui termic (4) și sunt protejate la radiatia termica de 300 K, de un ecran termic (5) care prin cuplare la treapta de 50 K a crioracitorul (1) reduce transferul termic radiativ la un nivel de 1,5 Watt; proba (10) supusă masurării este cuplată termic la un crioracitor (2), pentru controlul temperaturii acesteia, în domeniul 4,2-300 K; ansamblul este introdus într-o incita vidata, criostat (6) care prezintă un două canale axiale (7) și (8) care trec prin magnetul supraconductor și un alt canal (9) pentru introducerea probei de studiu (10) într-o poziție fixă în interiorul zonei de camp uniform; prin alimentarea bobinelor supraconductoare (3) de la sursa programabilă de c.c. la un curent  $I = 0\text{-}500$  A, se obține campul magnetic  $B = 0\text{ - }5$  T cu o uniformitate de  $10^{-3}$  în zona centrală a magnetului supraconductor, prin care trec cele două canale axiale (7) și (8), zona folosită pentru accesul radiatiilor gamma sau particulelor elementare în scopul aplicării acestora pe proba de masurat (10) și înregistrarea radiatiei emise de către detectorii (D1),(D2),(D3).

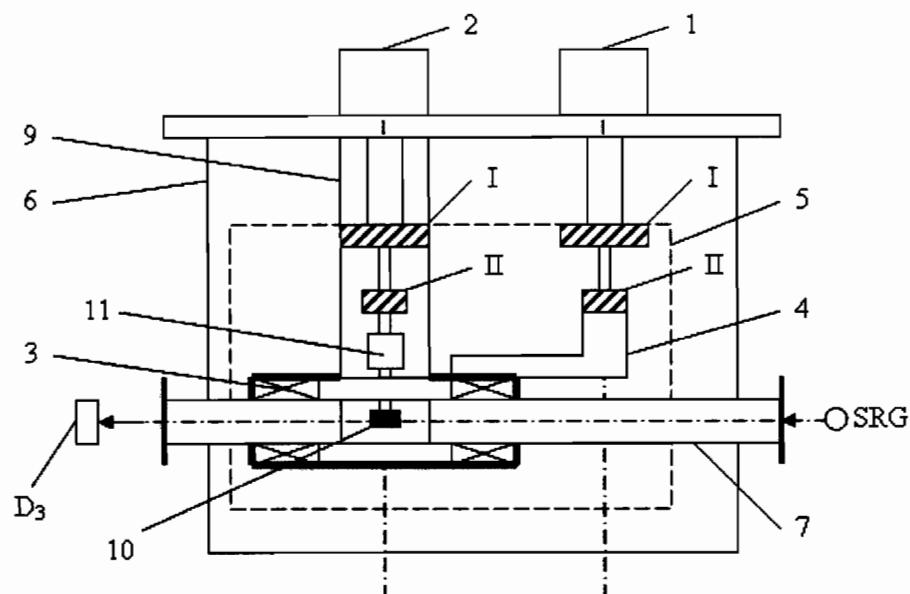


Fig. 1.

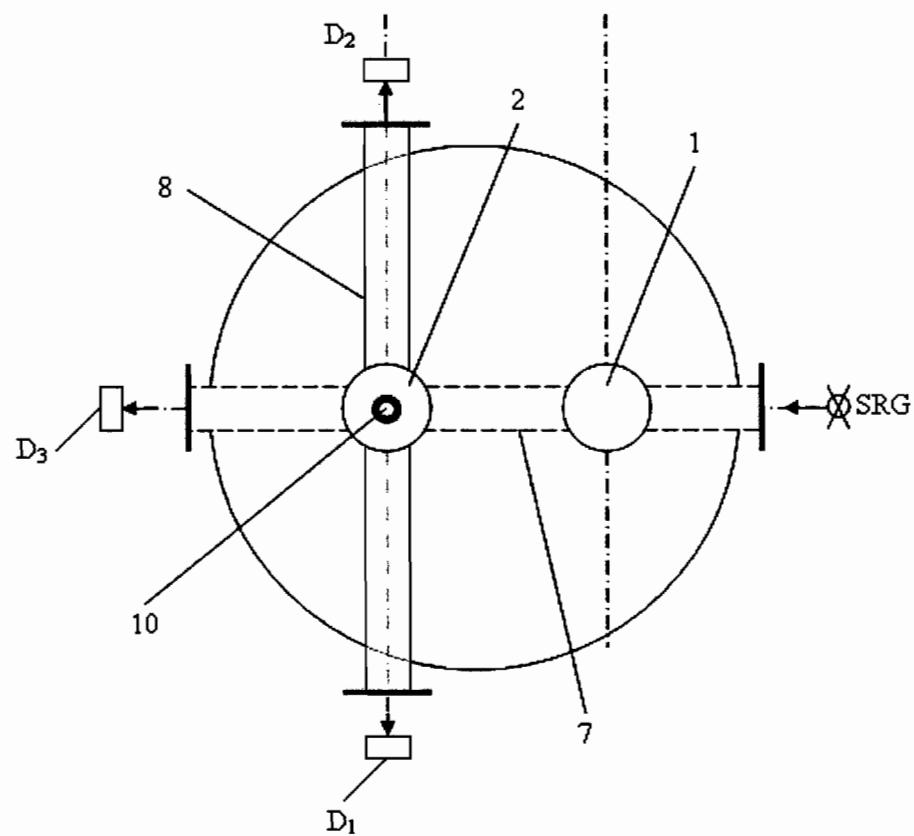


Fig. 2.